

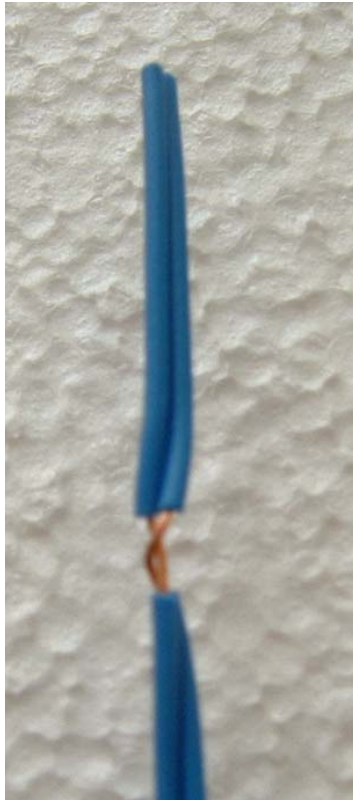


Inflamateur tel qu'il est livré :

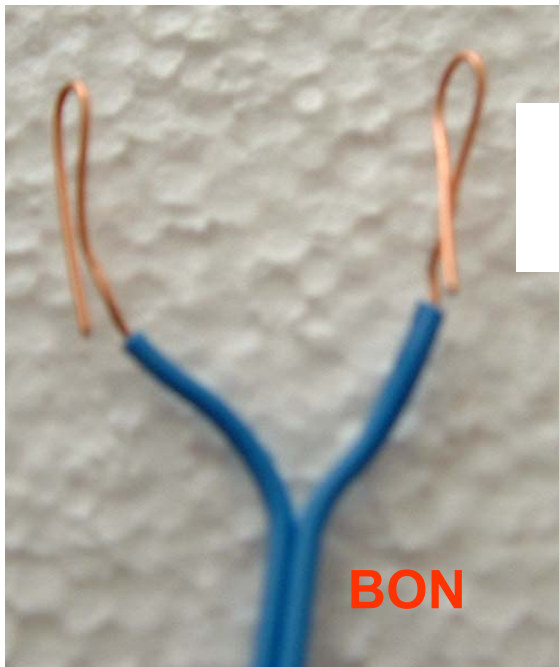

Inflamateur tel qu'il est livré, sans la gaine : MAUVAIS car court-circuit

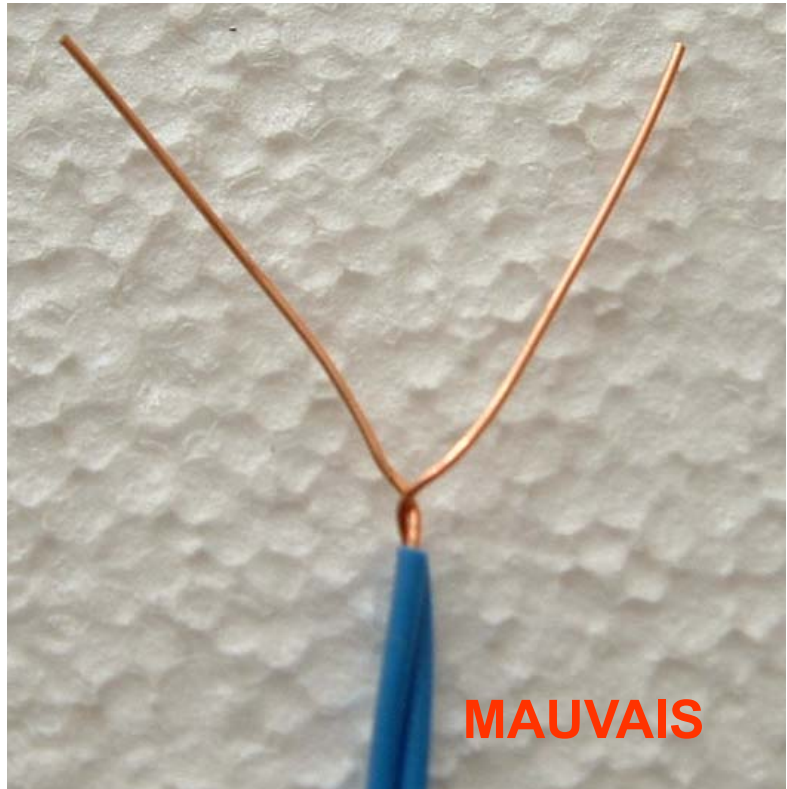

Inflamateur tel qu'il doit être : aucun risque de court-circuit

